BD IV Administration Sets

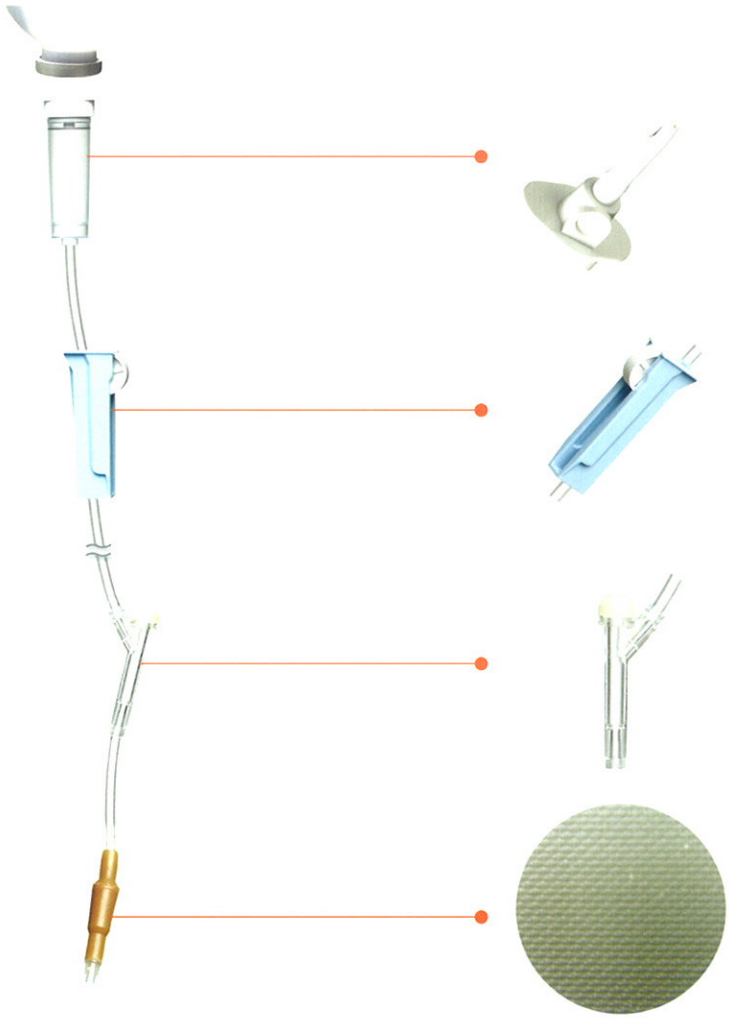

Spike
Easy spike insertion

Roller Clamp
400mm height from drip chamber
- Easy handling position
- Good roller clamp control

Y-Site
450mm height from luer end
- Easy handling position
- Convenient to fix

50μm Filter
- Reducing particle contamination

IV Set Priming

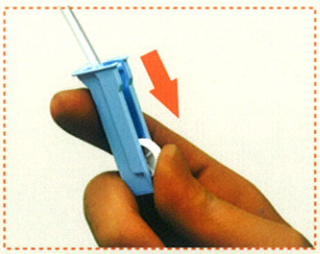

스파이크를 수액병(백)에 삽입하기 전에 롤러 클램프가 잠겨져 있는지 확인합니다.[1]

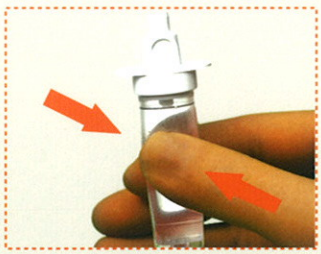

폴대에 수액병(백)을 걸고 수액세트 챔버의 중간부분을 눌러 수액을 1/2 채웁니다.[1]

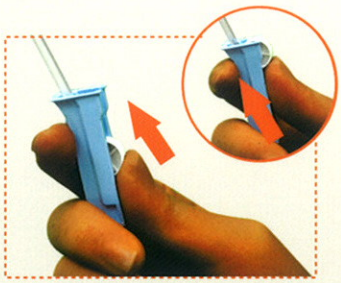

수액을 IV 라인에 채우기 위해 롤러 클램프를 서서히 열고 조절합니다.[1] 수액이 롤러 클램프까지 내려오면 롤러 클램프를 완전히 열어 전체 라인을 채워줍니다.

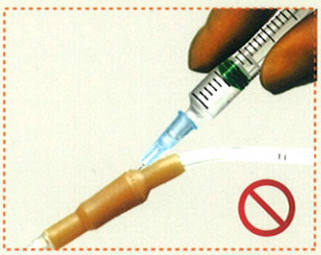

고무부위를 바늘로 찌르는 것은 다음과 같은 이유로 위험합니다.
· 오염 · 주사바늘 찔림 사고 · 찔린 부위에서의 누출

프라이밍 시 수액 세트 라인을 꺾지 않도록 합니다.

[1] Infusion Nursing An Evidence-Based Approach, Third Edition: P.457

BD Medical
서울특별시 강남구 논현로64길 4
02)3404-3700
www.bd.com

BD and BD Logo are trademark of Becton, Dickinson and Company.©2013 BD KRM-04130093 0413

BD IV Administration Sets

Your Partner in Medication Delivery

BD

Helping all people live healthy lives

Type	Cat. #	Description	Needle	Tubing Length	Shelf Pack	Cartoon Box
For Bottle	59012055	A115F (BP)	23G, 1"	1,700mm	25	500
	59012255	A111F	23G, 1"	1,700mm	25	500
	59012555	A125F (BP)	None	2,000mm	25	500
	59012855	A123F	None	2,000mm	25	500
	59012955	A120F (BP)	None	1,700mm	25	500
	59013055	A113F	None	1,700mm	25	500
	59013855	S404F with Y-Site (BP)	None	1,950mm	25	500
	59013955	Multi Set 113-922F 2Y (BP)	None	2,600mm	20	400
	59111655	S402F with Y-Site	None	1,950mm	25	500
For Bag	59016355	B310F with Y-Site (BP)	None	1,950mm	25	500
	59156455	B304F	None	1,700mm	25	500
	59165155	B306F (BP)	None	2,000mm	25	500
For Pump	59217355	A122F (PUMP T-TYPE)	None	2,000mm	20	400